


林口長庚醫院質子暨放射治療中心

輻射管制區輻射安全注意事項

1. 非輻射工作人員因需要必須進入本中心輻射管制區者，應先徵求本中心輻射防護人員同意並登記後進入。管制區域如下圖所示。進入迴旋加速器須另外提出申請。
2. 本中心輻射源為 230 MeV 質子束迴旋加速器一部，其射束可到達之空間包含有加速器室、射束室、治療室及第五間射束實驗室等。
3. 進入一般輻射管制區期間應遵守本中心有關規定並依照輻射防護人員指示，嚴禁吸煙、飲食。不得擅自行動，以免誤入高輻射區域造成輻射意外事故。
4. 本人願遵照設施單位依「輻射工作場所管理與場所外環境輻射監測作業準則」第 7 條規定，並已了解輻射管制區內輻射源及安全設施資訊。

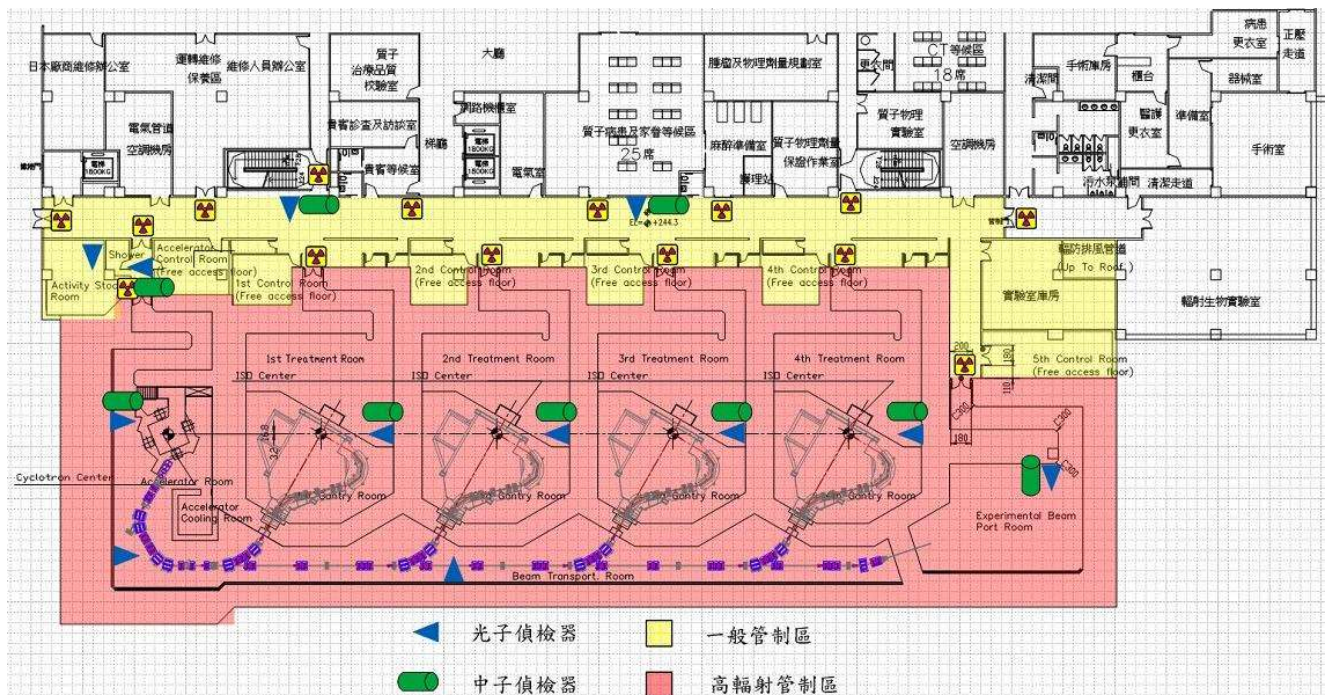

連絡人：陳顯鑫輻防師 連絡電話：0975-366-295

2018.9.11 修訂